

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “DIF PUERTO VALLARTA”, PRESENTADO POR LA LICENCIADA ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES Y, POR LA OTRA PARTE, FUNDACIÓN MVS RADIO, A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JORGE ANDRÉS VÁZQUEZ LARA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE LE IDENTIFICARÁ COMO “LA FUNDACIÓN”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.-A través de su Directora General “DIF PUERTO VALLARTA” declara que:

- A) Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, debidamente constituido, según Decreto 12019 doce mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, de fecha 11 once de Abril de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, mismo que ambas partes conocen y reconocen; con personalidad jurídica y patrimonial propia, que tiene entre otros objetivos el de asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos, conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal.
- B) Entre sus objetivos se encuentra ser una institución estructuralmente fortalecida y transparente en sus procesos de operación, recursos materiales, económicos y de capital humano en una búsqueda constante del profesionalismo integral. Ser líderes en la calidad de la asistencia social y desarrollo de los programas, actividades y acciones que permitan la proyección de una sociedad vallartense en constante crecimiento.
- C) Que la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, Jalisco, la **LIC. ZAIRA LILIBTH CASTILLON ROSALES**, cuenta con la personalidad jurídica y las facultades necesarias para obligar y contratarse en los términos del presente acuerdo de voluntades, tal y como se desprende por designación del Arq. Luis Ernesto Munguía González, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, conferido de conformidad con lo establecido en los artículos 155 fracción III de la Constitución
- D) Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 fracción II punto 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco; 41 fracción IV del reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, ratificada por el patronato del organismo en cita, en sesión extraordinaria de fecha del **03 TRES DE MARZO DEL AÑO 2025 DOSMIL VEINTICINCO**, de conformidad a los numerales artículo 9 fracción IX del DECRETO 12019 doce mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, de fecha 11 once de Abril de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, así como en

el numeral 22 fracción V del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

- E) Que, con fundamento descrito, cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presente instrumento jurídico.
- F) Que, para todos los efectos legales derivados del presente Instrumento Jurídico, señala como su domicilio el ubicado en **AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS S/N, EN LA COLONIA BARRIO SANTA MARIA, C.P. 48325 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.**
- G) Que se encuentra inscrito en el **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUCIONES** con la clave **SDI850412B24** por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.-“**LA FUNDACIÓN**” señala, a través de su representante:

- A) Que el objetivo social de “**LA FUNDACIÓN**” es, entre otros, cubrir los gastos relacionados a la rehabilitación y tratamiento de la discapacidad auditiva en niños jóvenes y adultos; la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda a grupos de escasos recursos o comunidades indígenas; el tratamiento y rehabilitación médica a grupos vulnerables, por edad, sexo o problemas de discapacidad, así como comunidades de escasos recursos o indígenas.
- B) Que es una asociación civil que se encuentra debida y legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según lo acredita con la Escritura pública número 52,052 cincuenta y dos mil cincuenta y dos del veintiuno de julio del año dos mil once, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Namur Campesino, Titular de la Notaría número 94 de la Ciudad de México.
- C) Que el C. , Lic. Jorge Andrés Vázquez Lara, tengo el carácter de Apoderado legal de “**LA FUNDACIÓN**”, cuenta con facultades suficientes para suscribir el siguiente **CONVENIO**, las cuales a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en ninguno de sus términos, según consta en la Escritura pública número 42,438 cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós , otorgada ante la fe de la Licenciada Olga M. García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría número 95 de la Ciudad de México.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es FMR-110721-874 y para efectos del presente **CONVENIO** señala como domicilio el ubicado en la calle Mariano Escobedo número 532, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; CP 11590.

III.- Ambas partes declaran que se reconocen la personalidad con la que comparecen y se manifiestan conformes en celebrar el presente contrato, el cual se sujetara al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

CONSENTIMIENTO

PRIMERA. -Las partes manifiestan que comparece este acto en plenitud de facultades, de manera libre y espontánea y que las cláusulas que a continuación se detallan constituyen la expresión fiel de su voluntad sin reservas y que conocen la trascendencia y efectos legales de firma.

OBJETO

SEGUNDA.-El contrato tiene por objeto establecer los términos y condiciones conforme a las cuales ambas partes colaboraran en la operación y desarrollo del programa asistencial **“PONTE OREJA”**, consistente en apoyar a la población vulnerable dentro del territorio de Puerto Vallarta, Jalisco, que sea afectada por discapacidad auditiva, para que lleguen a obtener determinados auxiliares auditivos que contribuyan a atender y combatir distintas pérdidas auditivas en la persona y, con ello, se ayude a mejorar sus condiciones de vida de la entidad.

Los lineamientos de operación se encuentran establecidos en el **Anexo A** “Lineamientos de operación”, mismo que **“LA FUNDACIÓN”** hará llegar vía correo electrónico al coordinador de la Jornada de Salud Auditiva Integral de **“DIF PUERTO VALLARTA”** previo a la realización del evento con el objetivo de asegurar su cumplimiento.

“DIF PUERTO VALLARTA” canalizará a los beneficiarios a la **Jornada de Salud Auditiva Ponte Oreja**, para llevar a cabo dicha jornada, en las instalaciones de:

“DIF PUERTO VALLARTA” en fecha **26 AL 27 DE AGOSTO 2025**, ubicado en Avenida Paseo de las Palmas S/N Colonia Barrio Santa María C.P. 48325.

TERCERA. - Para lo cual, **“DIF PUERTO VALLARTA”** y **“LA FUNDACIÓN”** acuerdan realizar de manera conjunta una Jornada de Salud Auditiva atendiendo de la siguiente manera:

- **100 auxiliares auditivos para 100 beneficiarios a quienes se les hará estudio de audiometría en “DIF PUERTO VALLARTA” el 26 AL 27 DE AGOSTO 2025 EN HORARIO DE 9 AM A 5 PM CADA DÍA.**

Estos auxiliares auditivos y audiometrías serán aportados por **“LA FUNDACIÓN”** y **“DIF PUERTO VALLARTA”** aportará la parte indicada del padrón de beneficiarios así como las instalaciones para llevar a cabo una **Jornada de Salud Auditiva**, con el propósito de que tales auxiliares auditivos que se lleguen a adquirir, sean entregados en donación a las personas con discapacidad auditiva, los cuales contarán con las características y especificaciones que se describen en el **Anexo B** que forma parte integral del presente contrato como sí a la letra se transcribiesen al presente instrumento jurídico.

CUARTA. - Por lo que **“DIF PUERTO VALLARTA”** entregará el padrón de beneficiarios a favor de **“LA FUNDACIÓN”** durante los tiempos acordados como logística operativa, a fin de coadyuvar

en común al programa “PONTE OREJA”, así como la logística para apoyar en los traslados y alimentación de 3 personas del Staff Pont Oreja durante la ejecución de la jornada.

QUINTA.- A su vez, “**LA FUNDACIÓN**” entregará a “**DIF PUERTO VALLARTA**”, el total de auxiliares auditivos conforme a la cantidad pactada en la cláusula TERCERA que antecede, así como por lo aportado por “**LA FUNDACIÓN**”.

SEXTA.- Con la finalidad de que el programa “PONTE OREJA” se encuentre enmarcado bajo el más amplio sentido de transparencia, “**DIF PUERTO VALLARTA**” remitirá a “**LA FUNDACIÓN**” los **listados o padrones de beneficiarios con los que se acredite la entrega de los auxiliares auditivos**

SÉPTIMA.- A efecto de lograr los objetivos del programa “PONTE OREJA” respectivo al **año 2025**, ambas partes se comprometen a dar cumplimiento a sus obligaciones, conforme a las fechas que a continuación se señalan:

- I. “**DIF PUERTO VALLARTA**” entregará a “**LA FUNDACIÓN**”, a **más tardar el día 11 de AGOSTO de 2025** las indicaciones logísticas correspondientes para poder llevar a cabo la: “Jornada de Salud Auditiva Integral Ponte Oreja Puerto Vallarta”
- II. “**DIF PUERTO VALLARTA**” entregará a “**LA FUNDACIÓN**”, a **más tardar el día 11 de agosto de 2025** la lista de beneficiarios de: “Jornada de Salud Auditiva Integral Ponte Oreja Puerto Vallarta”
- III. A su vez, “**LA FUNDACIÓN**” entregará a “**DIF PUERTO VALLARTA**” el total de auxiliares auditivos adquiridos conforme al presente convenio: **26 Y 27 de agosto de 2025** “Jornada de Salud Auditiva Integral Ponte Oreja Puerto Vallarta”.

OCTAVA.- Los auxiliares auditivos mencionados en el cuerpo del presente contrato, son entregados a sus beneficiarios con pilas suficientes para un año de funcionamiento.

Así mismo, “**DIF PUERTO VALLARTA**” se compromete a invitar a “**LA FUNDACIÓN**” al evento de entrega de los auxiliares auditivos, objeto del programa “PONTE OREJA”, dando los créditos e imagen correspondiente en el acto protocolario.

NOVENA. - “**DIF PUERTO VALLARTA**” debe entregar a “**LA FUNDACIÓN**” o a quién sus derechos representen, en un plazo máximo de **15 días hábiles** anteriores a la entrega física de los auxiliares auditivos, toda la documentación Fiscal correspondiente para cumplir con los requisitos que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en específico los siguientes documentos:

1. **Publicación de nombramiento de actual administración**
2. **Identificación del representante legal**
3. **Constancia de Situación Fiscal de “DIF PUERTO VALLARTA”**
4. **Constancia de Situación Fiscal del representante legal**

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

DÉCIMA. - Ambas partes se comprometen a llevar a cabo la promoción y difusión de las actividades asistenciales que desarrollan a favor de los beneficiarios, a través del programa previsto en el presente instrumento jurídico y/o de cualquier otro en el que participen y colaboren.

DÉCIMA PRIMERA. - Las partes manifiestan su conformidad en que este contrato se celebra bajo la cooperación y ayuda interinstitucional y por ende se comprometen a desarrollar sus obligaciones con el más alto sentido de profesionalismo.

DÉCIMA SEGUNDA. - La información y/o documentación que sea otorgada por las partes deberá ser utilizada única y exclusivamente para los fines del presente, siendo responsable las partes de su resguardo y buen uso.

DÉCIMA TERCERA. -Conviene a las partes que para la debida consecución de las acciones que se lleven a cabo en el marco del presente contrato, se podrán formalizar los adendums correspondientes, los cuales formarían parte integral del mismo estableciéndose por escrito las convocatorias, términos y/o fechas a cumplir en cada anualidad y/o convocatoria a que haya lugar.

RELACIÓN LABORAL

DÉCIMA CUARTA.-Los trabajadores de las partes que sean designados para la realización de actividades en ejecución de este contrato continuarán en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de aquella con la cual tiene establecida su relación laboral.

VIGENCIA

DÉCIMA QUINTA. - Las partes acuerdan que el presente contrato iniciará su vigencia a partir de la firma del mismo y fenecerá al término de la entrega total de auxiliares auditivos mencionados en la tercera cláusula, pudiendo ser adicionado o modificado de común acuerdo entre partes.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

DÉCIMA SEXTA. - Ambas partes manifiestan que cualquiera de ellas podrá dar por terminado anticipadamente el presente instrumento jurídico, previo aviso que por escrito realice la otra parte con una anticipación de 30 treinta días naturales, sin que exista responsabilidad alguna al respecto, salvo el llegar a hacer la devolución de recurso financiero que, en su caso, no llegare a ser ejercicio en la consecución de los fines establecidos alrededor del presente contrato de colaboración.

RESCISIÓN

DÉCIMA SEPTIMA. - Las partes convienen que en el caso de incumplimiento alguno de los compromisos plasmados en el presente contrato, podrá solicitarse por cualquiera de ellas la

rescisión, para lo cual bastará que se comunique por escrito a la otra parte, con el objeto de que dentro de un plazo máximo de 30 días naturales manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

FORMALIDADES

DÉCIMA OCTAVA. - El presente contrato se realiza por escrito y por duplicado entregándose en un tanto con firmas originales a cada una de las partes que en el invierten.

DÉCIMA NOVENA. - Las partes manifiestan que el presente contrato podrá ser modificado o adicionado, de común acuerdo de las partes, siempre y cuando no contravenga el fin principal por el cual fue elaborado.

NOTIFICACIONES

La comunicación entre las partes deberá ser mediante correo electrónico a los correos de direccion@difpuertovallarta.gob.mx, por parte de “DIF PUERTO VALLARTA” y por parte de “LA FUNDACIÓN” a pontoreja@mvs.com y fundacionmvsradio@mvs.com, de requerirlo la documentación deberá ser por escrito y entregadas en forma fehaciente en los domicilios que señalen partes con acuse de recibo; conviniendo a si mismo que para cualquier efecto de cambio de domicilio deberán de comunicarse en un plazo de 72 setenta y dos horas, a través de cualquier medio fehaciente que deje constancia de recepción y en el entendido que en caso de no hacerse, cualquier tipo de notificación hecha en los domicilios señalados en el presente instrumento surtirá todos los efectos legales y para tal efecto, se señalan los siguientes:

“DIF PUERTO VALLARTA”, ubicado en Avenida Paseo de las Palmas S/N Colonia Barrio Santa María C.P. 48325.

“LA FUNDACION”, ubicada en la calle Mariano Escobedo #532, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, C.P 11590.

JURISDICCIÓN Y APARTADO

VIGÉSIMA.-Las partes se acuerdan que en caso de conflicto o controversia respecto de la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento, agotaran, en primer término, los métodos alternativos de solución de conflictos, y, si no se llega a acuerdo alguno, se someterán a los tribunales competentes y a la legislación aplicable en la Ciudad de México, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiese corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como tales los que quedaron precisados con antelación.

Leído que fue el presente contrato enteradas las partes del contenido y alcances de cada una de las cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado en la Ciudad de México a **07 SIETE DE JULIO DE 2025 DOSMIL VEINTICINCO.**

“Firma”

POR “DIF PUERTO VALLARTA”	Fundación MVS Radio A.C.
<p>_____</p> <p>Lic. Zaira Lilibth Castellón Rosales Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, Jalisco.</p>	<p>_____</p> <p>Lic. Jorge Andrés Vázquez Lara Apoderado Legal</p>

“Testigos”

POR “DIF PUERTO VALLARTA”	Fundación MVS Radio A.C.
<p>_____</p> <p>T. A. Claudia Maricela Peña Gómez Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, Jalisco.</p>	<p>_____</p> <p>Lic. Ilich Magdiel Avilés Ramírez Coordinador de Programas Sociales</p>

ANEXO A
Lineamientos de Operación

Protocolo de atención: Paso a Paso



¡CUIDA TU SALUD!
Si detectas algún síntoma de COVID-19 infórmalo al:

☎ **800ESCUCHA**
(372.8242)
✉ ponteorejaamvs.com

“Firma”

POR “DIF PUERTO VALLARTA”	Fundación MVS Radio A.C.
<p>Lic. Zaira Lilibth Castellón Rosales Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, Jalisco.</p>	<p>Lic. Jorge Andrés Vázquez Lara Apoderado Legal</p>

“Testigos”

POR “DIF PUERTO VALLARTA”	Fundación MVS Radio A.C.
<hr/> <p>T. A. Claudia Maricela Peña Gómez Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, Jalisco.</p>	<hr/> <p>Lic. Ilich Magdiel Avilés Ramírez Coordinador de Programas Sociales</p>

ANEXO B: CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS AUXILIARES AUDITIVOS




Starkey | Datos Técnicos

POWER PLUS BTE 13

Retroauricular

Rango de Adaptación

● BTE 13 80



Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Guía de colores

Colores Estándar



Compatibilidad con accesorios 2.4 GHz



- Transmisor para Televisión
- Micrófono remoto +
- Control remoto
- Micrófono Remoto Mini
- Micrófono para mesa
- Programador

Características para el paciente

- IP Rating: 68
- Tecnología Tinnitus
- Conectividad Inalámbrica
- Teletobina

Tecnología Evolv AI

- Tecnología auditiva Healthable con sensores integrados e Inteligencia Artificial.

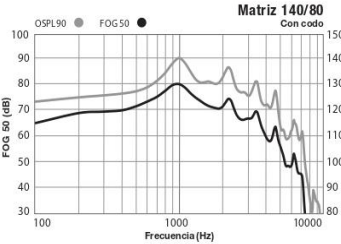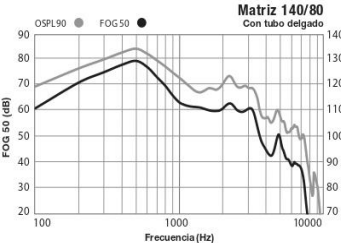Medida	Codo		Tubo delgado		Matrices: 140/80 Tamaño de pila: 13
	Acoplador 2cc ANSI/IEC	Acoplador 2cc IEC OES	Acoplador 2cc ANSI/IEC	Acoplador 2cc IEC OES	
Pico OSPL90 (dB SPL)	140	147	133	139	
HFA OSPL90 (dB SPL)	133	N/A	119	N/A	
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	141	N/A	128	
Pico de ganancia (dB)	80	86	78	84	
Ganancia máxima HFA (dB)	73	N/A	60	N/A	
Ganancia máxima RTF (dB)	N/A	81	N/A	70	
Rango de frecuencia (Hz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000	
Frec. de prueba de referencia (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
Frecuencias HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Frec. de prueba de referencia (dB)	54	64	44	52	
Ruido de entrada equivalente (dB)	26	26	37	34	
Distorsión armónica					
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2	
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3	
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2	
Sensibilidad de la bobina de inducción					
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	110	N/A	98	N/A	
RSETS	-4	N/A	-6	N/A	
HFA-SPLIV	110	N/A	100	N/A	
RTLS / ETLS	-4	N/A	-4	N/A	
HFA MASL (IEC) (dB SPL)	92	N/A	80	N/A	
Voltaje de pila (mA)	2.9	2.4	2.9	2.4	
Corriente Idle (mA)	2.0	2.0	2.0	2.0	
Duración estimada de la pila durante 16 horas al día					
13 Zinc Air (días)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*	
Terapia de estímulo Tinnitus					
Salida RMS máxima (dB SPL)	92		92		
Nivel de salida RMS compensado (dB SPL)	92		92		
Salida máxima de 1/3 de Octava (dB SPL)	92		92		

*Los resultados variarán en el uso inalámbrico.




Starkey | Datos Técnicos

BTE 13

Retroauricular

Rango de Adaptación

● BTE 13 70




Starkey | Datos Técnicos

BTE 13

Retroauricular.

Rango de Adaptación

● BTE 13 70



Evolv AI 1200 | 1000

Guía de colores

Colores Estándar



Compatibilidad con accesorios 2.4 GHz

- Transmisor para Televisión
- Micrófono remoto +
- Control remoto
- Micrófono Remoto Mini
- Micrófono para mesa
- Programador

Características para el paciente

- Tecnología Tinnitus
- Conectividad Inalámbrica
- Sistema CROS**
- Telebobina

Tecnología Evolv AI

- Tecnología auditiva Healthable con sensores integrados e inteligencia artificial.

Medida	Codo		Tamaño 3, ocluido. Tubo delgado.		Matrices: 130/70 Tamaño de pila: 13	
	ANSI/IEC Acoplador 2cc	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC Acoplador 2cc	IEC OES Acoplador	OSPL90	FOG 60
Pico OSPL90 (dB SPL)	130	136	124	129		
HFA OSPL90 (dB SPL)	122	N/A	112	N/A		
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	134	N/A	114		
Pico de ganancia (dB)	70	76	68	73		
Ganancia máxima HFA (dB)	62	N/A	57	N/A		
Ganancia máxima RTF (dB)	N/A	73	N/A	61		
Rango de Frecuencia (Hz)	<100-7600	<100-7600	<100-4600	<100-6800		
Frec. de prueba de referencia (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6		
Frecuencias HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A		
Frec. de prueba de referencia (dB)	45	59	35	39		
Ruido de entrada equivalente (dB)	24	18	29	29		
Distorsión Armónica						
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3		
800 Hz (%)	<5	<5	<3	<3		
1600 Hz (%)	<2	<2	<2	<2		
Sensibilidad de la bobina de inducción						
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	101	N/A	91	N/A		
MASL (IEC) (dB SPL)	92	N/A	88	N/A		
ANSI/IEC Voltaje de pila (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*		
Corriente de reposo (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*		
Duración estimada de pila por 16 horas						
312 Zinc Air (días)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*		
Terapia de estímulo tinnitus						
Salida RMS máxima (dB SPL)	87		87			
Nivel de salida RMS compensado (dB SPL)	87		87			
Salida máxima de 1/3 de octava (dB SPL)	87		87			
Terapia de estímulo tinnitus						
Salida RMS máxima (dB SPL)	87		87			
Nivel de salida RMS compensado (dB SPL)	87		87			
Salida máxima de 1/3 de octava (dB SPL)	87		87			

*Los resultados variarán según el uso inalámbrico.
**Disponible sólo en tecnología tier 1200.

Starkey y Evolv son marcas comerciales de Starkey Laboratories Inc.
© 2021 Derechos reservados 3/21




Starkey Datos Técnicos

RIC 312 AP

Receptor en el canal **ABSOLUTE POWER**

Rango de adaptación

- RIC 312 60 AP
- RIC 312 70 AP



Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Guía de colores

Colores Estándar



Compatibilidad con accesorios 2.4 GHz

- Transmisor para Televisión
- Micrófono remoto +
- Control remoto
- Micrófono Remoto Mini
- Micrófono para mesa
- Programador

Características para el paciente


- Tecnología Tinnitus
- Conectividad Inalámbrica
- Sistema CROS

Tecnología Evolv AI

- Tecnología auditiva Healthable con sensores integrados e inteligencia artificial.

Medida	Datos de Ganancia 60		Datos de Ganancia 70	
	ANSI/IEC Acoplador 2cc	Acoplador IEC OES	ANSI/IEC Acoplador 2cc	Acoplador IEC OES
Pico OSPL90 (dB SPL)	123	133	130	140
HFA OSPL90 (dB SPL)	117	N/A	124	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	130	N/A	139
Pico de ganancia (dB)	60	70	70	81
Ganancia máxima HFA (dB)	54	N/A	65	N/A
Ganancia máxima RTF (dB)	N/A	66	N/A	78
Rango de Frecuencia (Hz)	<100-5500	<100-5700	<100-5800	<100-5700
Frec. de prueba de referencia (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frecuencias HFA (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Frec. de prueba de referencia (dB)	40	55	47	64
Ruido de entrada equivalente (dB)	26	26	26	26
Distorsión Armónica				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
Sensibilidad de la bobina de inducción				
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Voltaje de pila (mA)	1.7*	1.7*	1.9*	1.8*
Corriente de reposo (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*
Duración estimada de pila por 16 horas				
312 Zinc Air (días)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
Terapia de estímulo tinnitus				
Salida RMS máxima (dB SPL)	87		87	
Nivel de salida RMS compensado (dB SPL)	87		87	
Salida máxima de 1/3 de octava (dB SPL)	87		87	

*Los resultados variarán según el uso inalámbrico.

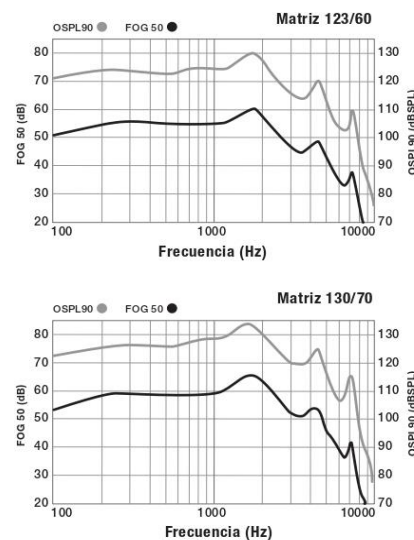




Starkey | Datos Técnicos

RIC 312

Receptor en el canal

Rango de adaptación

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60



Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Guía de colores

Colores Estándar



Compatibilidad con accesorios 2.4 GHz




- TV streamer
- Remote Microphone +
- Remote
- Mini Remote Microphone
- Table Microphone
- Programmer

Características para el paciente

- Tecnología Tinnitus
- Conectividad Inalámbrica
- Sistema CROS

Tecnología Evolv AI

- Tecnología auditiva Healthable con sensores integrados e inteligencia artificial.

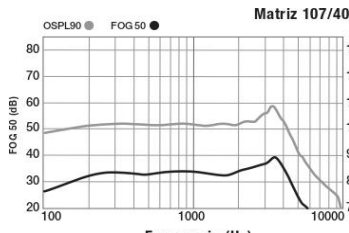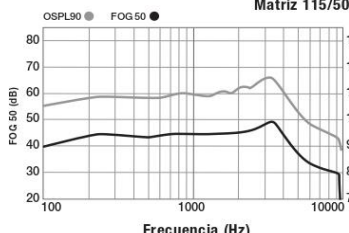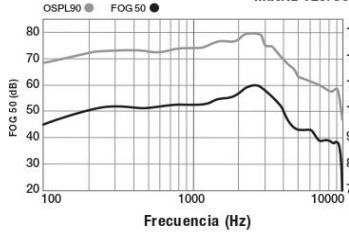
Medida	Datos de Ganancia 40		Datos de Ganancia 50		Datos de Ganancia 60		Matrices: 107/40, 115/50, 120/60 Tamaño de pila: 312
	ANSI/IEC 2cc Coupler	IEC OES Coupler	ANSI/IEC 2cc Coupler	IEC OES Coupler	ANSI/IEC 2cc Coupler	IEC OES Coupler	
Pico OSPL90 (dB SPL)	107	120	115	127	120	131	 <p>Matriz 107/40</p>
HFA OSPL90 (dB SPL)	102	N/A	109	N/A	117	N/A	
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	112	N/A	119	N/A	127	
Pico de ganancia (dB)	40	52	50	63	60	71	
Ganancia máxima HFA (dB)	35	N/A	45	N/A	56	N/A	
Ganancia máxima RTF (dB)	N/A	43	N/A	55	N/A	65	
Rango de Frecuencia (Hz)	<100-9400	<100-9400	<100-9600	<100-9600	<100-9200	<100-9600	 <p>Matriz 115/50</p>
Frec. de prueba de referencia (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6	
Frecuencias HFA (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	
Frec. de prueba de referencia (dB)	25	36	32	44	40	52	
Ruido de entrada equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26	 <p>Matriz 120/60</p>
Distorsión Armónica							
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
Sensibilidad de la bobina de inducción							
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ANSI/IEC Voltaje de pila (mA)	1.8*	1.7*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*	
Corriente de reposo (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*	
Duración estimada de pila por 16 horas							
312 Zinc Air (días)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	
Terapia de estímulo tinnitus							
Salida RMS máxima (dB SPL)	87		87		87		
Nivel de salida RMS compensado (dB SPL)	87		87		87		
Salida máxima de 1/3 de octava (dB SPL)	87		87		87		

*Los resultados variarán según el uso inalámbrico.



Starkey | Datos Técnicos
RIC 312 AP
Receptor en el canal ABSOLUTE POWER

Rango de adaptación
● RIC 312 60 AP
● RIC 312 70 AP



Evolv AI 1200 | 1000

Guía de colores

Colores Estándar



Compatibilidad con accesorios 2.4 GHz

- Transmisor para Televisión
- Micrófono remoto +
- Control remoto
- Micrófono Remoto Mini
- Micrófono para mesa
- Programador


Características para el paciente

- Tecnología Tinnitus
- Conectividad Inalámbrica

Tecnología Evolv AI

- Tecnología auditiva Healthable con sensores integrados e inteligencia artificial.

Medida	Datos de Ganancia 60		Datos de Ganancia 70	
	ANSI/IEC Zcc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC Zcc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico OSPL90 (dB SPL)	123	133	130	140
HFA OSPL90 (dB SPL)	117	N/A	124	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	130	N/A	139
Pico de ganancia (dB)	60	70	70	81
Ganancia máxima HFA (dB)	54	N/A	65	N/A
Ganancia máxima RTF (dB)	N/A	66	N/A	78
Rango de Frecuencia (Hz) <100-5500 <100-5700 <100-5800 <100-5700				
Frec. de prueba de referencia (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frecuencias HFA (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Frec. de prueba de referencia (dB)	40	55	47	64
Ruido de entrada equivalente (dB)	26	26	26	26
Distorsión Armónica				
500 Hz (%)	<-3	<-3	<-3	<-3
800 Hz (%)	<-3	<-3	<-3	<-3
1600 Hz (%)	<-3	<-3	<-3	<-3
Sensibilidad de la bobina de inducción				
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Voltaje de pila (mA)	1.7*	1.7*	1.9*	1.8*
Corriente de reposo (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*
Duración estimada de pila por 16 horas				
312 Zinc Air (días)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
Terapia de estímulo tinnitus				
Salida RMS máxima (dB SPL)	87		87	
Nivel de salida RMS compensado (dB SPL)	87		87	
Salida máxima de 1/3 de octava (dB SPL)	87		87	

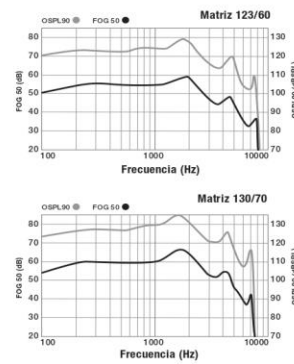

*Los resultados varían según el uso inalámbrico.
**Disponible sólo en tecnología Evolv 1200.

Starkey y Evolv son marcas comerciales de Starkey Laboratories Inc.
SPEC2060-00-EE-01 ©2021 Audibel. Derechos reservados 321

“Firma”

POR “DIF PUERTO VALLARTA”	Fundación MVS Radio A.C.
<p>_____</p> <p>Lic. Zaira Lilibth Castellón Rosales Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, Jalisco.</p>	<p>_____</p> <p>Lic. Jorge Andrés Vázquez Lara Apoderado Legal</p>

“Testigos”

POR “DIF PUERTO VALLARTA”	Fundación MVS Radio A.C.
<p>_____</p> <p>T. A. Claudia Maricela Peña Gómez Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, Jalisco.</p>	<p>_____</p> <p>Lic. Ilich Magdiel Avilés Ramírez Coordinador de Programas Sociales</p>